接続説明書
H101BX

オリンパス正立顕微鏡
BX シリーズ用　電動ステージ

2012 年 5 月現在

目次

ステージの顕微鏡への固定

1. 同梱の六角レンチ（1.5mm）を使用して、ステージ裏面にあるステージ固定ネジを緩めて下さい

ステージ固定ネジ
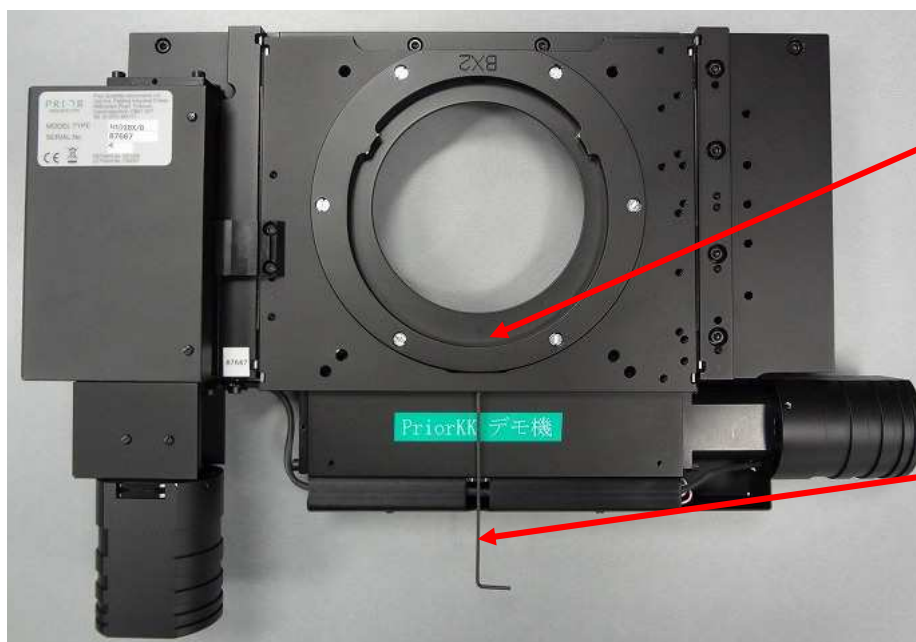
このネジの頭が見えなくなるくらいにまで、同梱の六角レンチを使用して緩めて下さい。

同梱六角レンチ

2. ステージを、顕微鏡のステージ用台座にしっかりと乗せ、その後同梱の六角レンチ（1.5 ㎜）でステージ固定用ネジを締めて、顕微鏡に固定して下さい

ステージを確実に固定するための注意点

ご注意：　透過照明観察の場合、ステージとの干渉を避けるため、長焦点コンデンサ（型式　U-LWCD）をご利用ください。

コントローラへの接続

1. ステージの右側面にあるコネクタに、ステージケーブルを接続します。

2. ステージ用ケーブル、ジョイスティック用ケーブル、電源ケーブルをコントローラ背面の各コネクタに接続します。
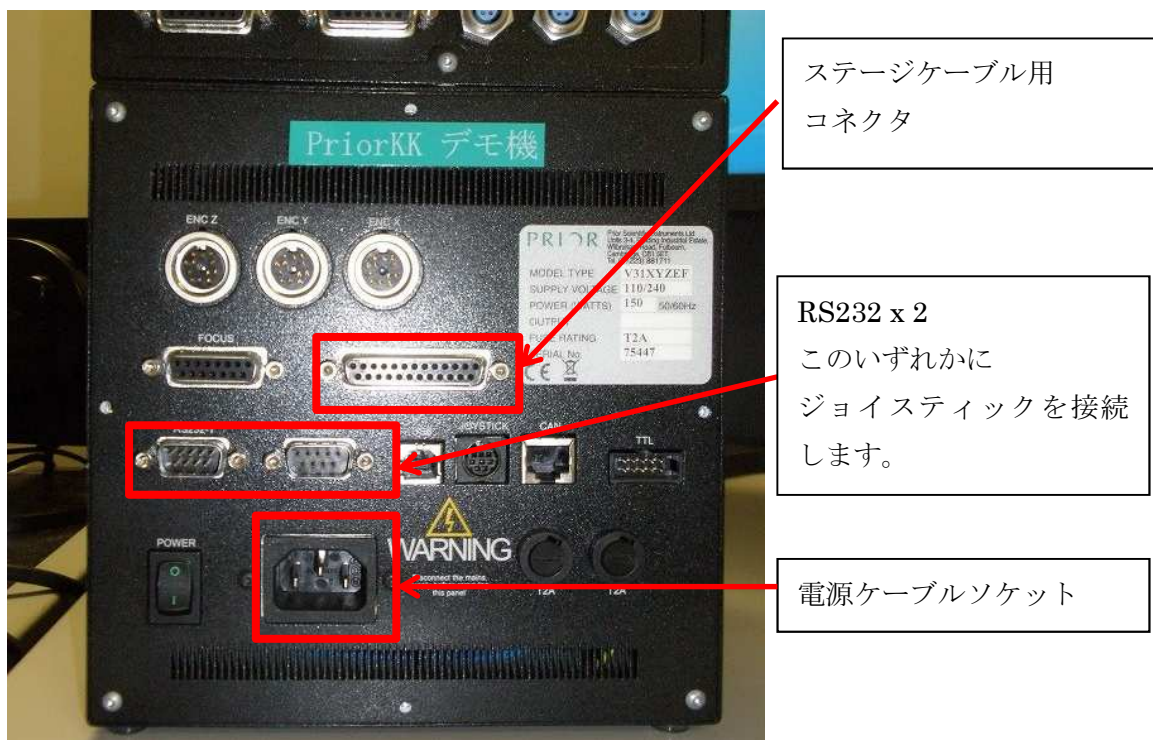
3. コントローラの電源をオンにし、ジョイスティックを動かし、ステージが稼働することを確認して下さい（ジョイスティックの操作方法に関しては、「ProScan III 用ジョイスティック」の取扱説明書をご参照下さい)。

サンプルホルダーの取り付け

サンプルホルダーは、固定用バネが固めのため、向かって右側から斜めに滑り込ませるように挿入すると、比較的楽に挿入することができます。
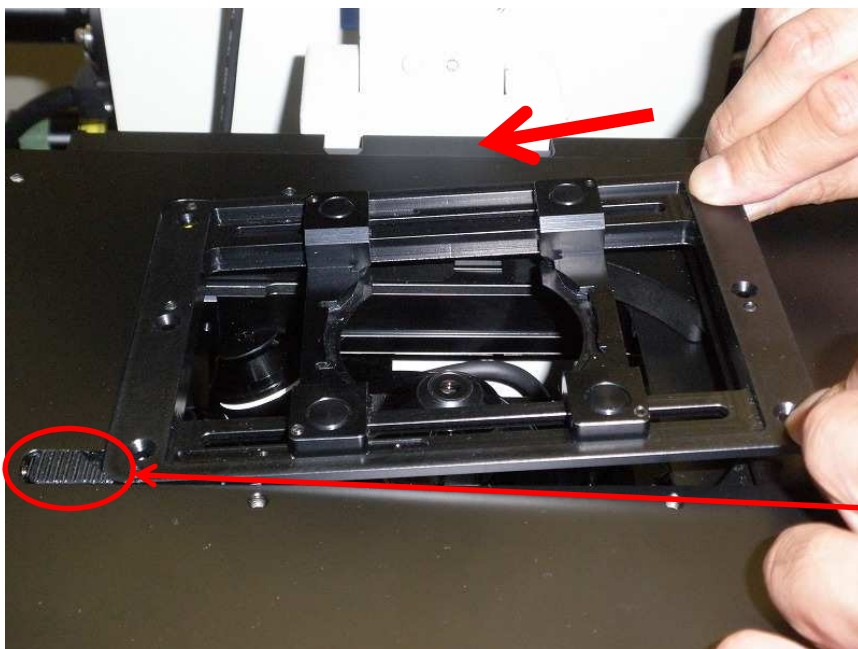
写真のように、右斜め上から滑り込ませる。

このバネが固めのため
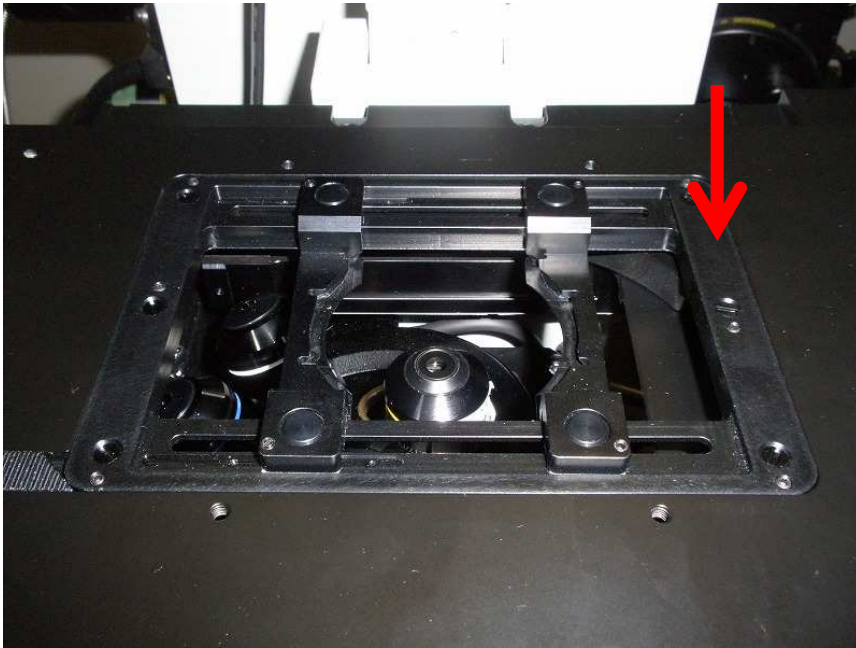
その後、サンプルホルダー右側を押し込む

付属のネジで固定します。
（左右３ヶ所ずつ）

以上